



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

發行日期 Date of Issue: 2021.03.17 收件/試驗起始日期 Date of Receipt and Test Start: 2021.03.03

報告編號 Report No.: TAGOC032 數量 Quantity: 1件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P1/4) 來文字號 Ref. No.: 空白

報告抬頭 Report Title: 台灣京富醫材有限公司(U3603) 試件類別 Item: 口罩

地址 Address: 503 彰化縣花壇鄉花橋街83巷18號

試驗項目	試驗結果	試驗方法
*合成血液穿透性	無穿透	CNS 14774 T5017-2018 9.1
壓力:160 mmHg	無穿透	CNS 14776 T4038-2003
	無穿透	
	無穿透	
	無穿透	
	無穿透	
	無穿透	
	無穿透	
	無穿透	
	無穿透	
	無穿透	
	無穿透	
	無穿透	
	無穿透	
	無穿透	

本試驗報告僅供參考
不做任何正式文件證明用



註：依委託者所提供來樣資料為：台灣京富醫療口罩

註：試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。

註：檢驗項目有標"*"者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

附記: 1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人: 
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108 , +886-2-22689839



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

發行日期 Date of Issue: 2021.03.17 收件/試驗起始日期 Date of Receipt and Test Start: 2021.03.03

報告編號 Report No.: TAGOC032 數量 Quantity: 1件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P2/4) 來文字號 Ref. No.: 空白

報告抬頭 Report Title: 台灣京富醫材有限公司(U3603) 試件類別 Item: 口罩

地址 Address: 503 彰化縣花壇鄉花橋街83巷18號

試驗項目	試驗結果	試驗方法
*空氣交換壓力差 (mmH ₂ O/cm ²)	1	4.3
	2	4.0
	3	4.2
	4	4.0
	5	4.2
微粒過濾效率(%) (0.1 μm PSL)	1	99.23
	2	99.28
	3	99.29
	4	99.25
	5	99.26
	平均	99.26
*現狀防火性	縱向	不著火
	橫向	不著火
	評級	1級

本試驗報告僅供參考
不做任何正式文件證明用

註：空氣交換壓力差，取5個樣品測試。

註：空氣交換壓力差測試面積：4.9 cm²。

註：現狀防火性，取20個試片測試。

註：依委託者所提供來樣資料為：台灣京富醫療口罩

註：試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。

註：檢驗項目有標"*"者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

附記：1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.

2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.

3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人：
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute



紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108 , +886-2-22689839



試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

發行日期 Date of Issue: 2021.03.17 收件/試驗起始日期 Date of Receipt and Test Start: 2021.03.03

報告編號 Report No.: TAG0C032 數量 Quantity: 1件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P3/4) 來文字號 Ref. No.: 空白

報告抬頭 Report Title: 台灣京富醫材有限公司(U3603) 試件類別 Item: 口罩

地址 Address: 503 彰化縣花壇鄉花橋街83巷18號

試驗項目	試驗結果	試驗方法
*細菌過濾效率(%)	99.9	CNS 14774-T5017-2018 9.2
金黃色葡萄球菌	99.8	CNS 14775 T4037-2003
ATCC 6538	99.9	本試驗報告僅供參考， 不做任何正式文件證明用
	99.8	
	99.8	

註：對照組的平均菌落數：2031 CFU。

註：平均粒徑：3.3 μm。

註：測試面：外側。


註：測試面積：39.5 cm²。

註：測試流量：28.3 L/min。

註：依委託者所提供來樣資料為：台灣京富醫療口罩

註：試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。

註：檢驗項目有標"*"者，指該檢驗項目經衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

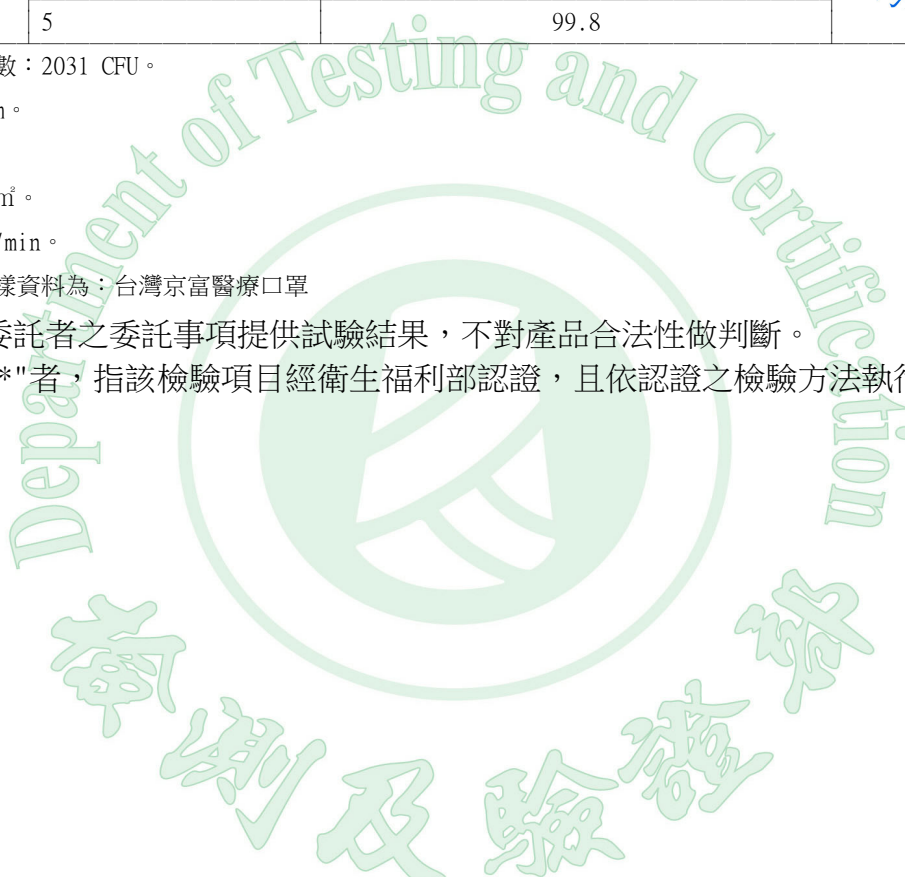

附記: 1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.

2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。

This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.

3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人:
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute



紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108 , +886-2-22689839

試驗報告 土城場區
TEST REPORT TUCHENG

發行日期 Date of Issue: 2021.03.17 收件/試驗起始日期 Date of Receipt and Test Start: 2021.03.03

報告編號 Report No.: TAG0C032 數量 Quantity: 1件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P4/4) 來文字號 Ref. No.: 空 白

報告抬頭 Report Title: 台灣京富醫材有限公司(U3603) 試件類別 Item: 口罩

地址 Address: 503 彰化縣花壇鄉花橋街83巷18號

本試驗報告僅供參考，
不做任何正式文件證明用



附記: 1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.
2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.
3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所
所長授權核發人: _____
Authorized by president of
Taiwan Textile Research Institute

檢測及驗證部 高瑞宏
主 任

紡織產業綜合研究所檢測及驗證部 新北市土城區承天路6號
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839